



# Adia<sup>X</sup> Lyo

Notice d'utilisation  
ADL55Y2-ASFV\_NO\_(FR)\_V01  
01/2024

## ASFV Triplex

Référence : ADL55Y2-100 & ADL55Y2-1000

Test pour la détection du virus de la Peste Porcine Africaine (ASFV) par amplification enzymatique de gène en temps réel

Test PCR – 100 & 1000 réactions

### Usage *in vitro* et strictement vétérinaire



Echantillon	Analyse individuelle	Analyse en mélange*, possible jusqu'à
Sang EDTA, sérum, plasma ou surnageant de culture cellulaire	✓	20
Rate, amygdale ou ganglion	✓	10
Ecouvillon de sang ou d'exsudat	✓	✗
Moelle osseuse	✓	✗
Prélèvements environnementaux	✓	✗

\* Dépend de la situation épidémiologique, de la qualité de l'échantillon et des directives spécifiques qui existent dans certains pays (s'y référer).

## Composition du kit

Matériel fourni		Kit ADL55Y2	
		100 réactions	1000 réactions
A6	Solution d'amplification	1 flacon lyophilisé (A reconstituer)	10 flacons lyophilisés (A reconstituer)
Rehydratation buffer	Solution de réhydratation	1 x 6 mL flacon (Réactif prêt à l'emploi)	2 x 6 mL flacons (Réactif prêt à l'emploi)
ASFV CTL+	Contrôle positif ASFV	1 tube à bouchon violet (A reconstituer)	2 tubes à bouchon violet (A reconstituer)
EPC-Ext	Contrôle exogène non-cible d'extraction	1 flacon à bouchon jaune (A reconstituer)	6 flacons à bouchon jaune (A reconstituer)
NF-Water	Eau Nucléase Free	2 x 1000 µL tubes à bouchon blanc (Réactif prêt à l'emploi)	1 x 10 mL flacon (Réactif prêt à l'emploi)

## Historique de révision

Date	Version	Modifications
01/2024	V01	Création

Note : les modifications mineures concernant la typographie, la grammaire et la mise en forme ne sont pas incluses dans l'historique des révisions.

## A. Introduction

La Peste Porcine Africaine est une maladie hémorragique hautement contagieuse qui touche les porcs, les phacochères, les sangliers d'Europe et d'Amérique. Toutes les classes d'âge sont sensibles à la maladie. L'agent pathogène responsable est l'ASFV (African Swine Fever Virus), un virus ADN double brin de la famille des Asfarviridae.

Sous ses formes hautement virulentes, la peste porcine africaine se caractérise par une forte fièvre, une perte d'appétit, des hémorragies au niveau de la peau et des organes internes ; la mort survient en 2 à 10 jours en moyenne. La mortalité peut atteindre 100%.

Cliniquement, il est difficile de différencier les infections dues au virus de la Peste Porcine Classique causée par le virus Classical Swine Fever Virus (CSFV) de celles dues à ASFV, d'où la nécessité d'un diagnostic différentiel en laboratoire. La PCR est un outil hautement sensible et rapide pour la mise en évidence du ASFV et sa différenciation du CSFV.

## B. Principe du test

Le test ADIALYO™ ASFV Triplex repose sur l'amplification génique de fragments d'ADN spécifiques du virus de la peste porcine africaine. Il détecte simultanément en monocouche :

- ASFV : Virus de la Peste Porcine Africaine (sonde marquée en FAM).
- RNase P : un contrôle interne d'extraction et d'amplification spécifique d'ADN endogène (sonde marquée en HEX ou équivalent).
- EPC-Ext : un contrôle interne d'extraction et d'amplification d'acide nucléique exogène (sonde marquée en Cy5).

## C. Conditions de stockage

A réception, stocker le kit à +2/8 °C et au sec.

Les réactifs reconstitués doivent être aliquotés et stockés à une température inférieure à -15 °C jusqu'à la date de péremption du kit. Stocker à l'abri de la lumière.

Ne pas décongeler plus de 3 fois.

## D. Matériel supplémentaire et réactifs requis non fournis

- Thermocycleur avec son consommable pour PCR Temps réel.
- Appareil d'homogénéisation pour tubes.
- Pipettes de 1 - 10 µL, 20 - 200 µL et 200 - 1000 µL.
- Embouts Nucléase-free avec filtres pour micropipettes.
- Microtubes Nucléase-free de 1,5 mL et 2 mL.
- Gants latex ou nitrile non poudrés.
- Eau Nucléase-free.
- Kit d'extraction des acides nucléiques.

### Kits complémentaires pour Adoption de méthode et PCR (U47-600)

- **Extraction Positive Control ASFV (Réf. : ADC55EPC).** Matériel de référence fournisseur pour adoption de méthode pouvant également être utilisé comme sentinelle.
- **LDpccr Positive Control – ASFV (Réf. : ADC55LD)** Confirmation des performances – LDpccr du kit.

## E. Précautions d'utilisation et de sécurité

- Pour usage vétérinaire *in vitro* uniquement.
- Pour usage animal uniquement.
- Pour usage professionnel uniquement.
- Lire l'ensemble du protocole avant de commencer et le respecter scrupuleusement.
- Ne pas utiliser les réactifs après la date de péremption du kit.
- Ne pas utiliser les réactifs dont l'emballage est détérioré.

- Ne pas mélanger des réactifs de différents lots.
- Ne pas ouvrir les tubes PCR après amplification.
- Éliminer le matériel utilisé en respectant la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets biologiques.
- Ce coffret contient des composants d'origine animale. La maîtrise de l'origine et/ou de l'état sanitaire des animaux ne pouvant garantir de façon absolue que ces produits ne contiennent aucun agent pathogène transmissible, il est recommandé de les manipuler avec les précautions d'usage relatives aux produits potentiellement infectieux (ne pas ingérer ; ne pas inhaler).

## F. Extraction des acides nucléiques

### 1. Kits d'extractions

Les acides nucléiques doivent être extraits à partir des échantillons avant d'utiliser le kit. Les kits d'extraction ADN/ARN listés ci-dessous sont recommandés et fournis par Bio-X Diagnostics :

Nom du produit	Technologie d'extraction	Nombre de tests et référence
ADIAMAG™	Billes magnétiques	200 tests : réf. NADI003 800 tests : réf. NADI003-XL
ADIAMAG™ LB3 buffer	Tampon pour billes magnétiques	125 mL : réf. NADI004

Pour l'extraction, se référer à la version de notice disponible sur le site web, indiqué sur le certificat d'analyse inclus dans le kit PCR utilisé.

Les protocoles d'extraction validés ou évalués sont présentés dans le dossier de validation. D'autres kits d'extraction peuvent être utilisés après validation par l'utilisateur.

Après extraction, les acides nucléiques extraits peuvent être conservés à +2/8 °C pendant quelques heures avant utilisation. Pour une conservation plus longue, ils doivent être conservés à une température inférieure à -15 °C.

### 2. Témoins

L'emploi de témoins permet de contrôler la fiabilité des résultats. Les témoins sont inclus par série d'analyse selon les recommandations définies par les normes en vigueur (Cf. AFNOR U47-600...).

Contrôles	Validation de	Mode opératoire
Témoin réactif (NTC)	Absence de contamination pour l'amplification	5 µL NF-Water dans un puits par série PCR
ASFV CTL+	Amplification de la cible	5 µL CTL+ dans un puits par série PCR
Témoin négatif d'extraction	Absence de contamination pour l'extraction et l'amplification	1 extraction (eau ou tampon de lyse) par série d'extraction
Témoin positif d'extraction	Étapes d'extraction et d'amplification	1 extraction (Échantillon positif entre 1 et 100X LD <sub>Méthode</sub> ) par série d'extraction

## G. Mode opératoire

### 1. Préparation de la solution d'amplification A6

- Ajouter **1000 µL** de « **Rehydration buffer** » par tube de A6.
- Homogénéiser le tube à l'aide d'un agitateur de type vortex > 20 secondes.

- Après reconstitution, aliquoter et stocker la solution à une température inférieure à -15 °C jusqu'à la date de péremption du kit. Ne pas décongeler plus de 3 fois.
- Pour l'utilisation, se reporter au § « Amplification », Etape 1.

## 2. Préparation des contrôles

### a. Utilisation de l'EPC-Ext

L'EPC-Ext doit être ajouté dans les échantillons et les témoins d'extraction. Il permet de mettre en évidence la présence de potentiels inhibiteurs.

- Ajouter **1000 µL** de « **NF-Water** » par tube.
- Homogénéiser le tube à l'aide d'un agitateur de type vortex > 20 secondes.
- Après reconstitution, aliquoter et stocker la solution à une température inférieure à -15 °C jusqu'à la date de péremption du kit. Ne pas décongeler plus de 3 fois.
- Pour l'utilisation, ajouter **5 µL** d'EPC-Ext dans le premier tampon de lyse lors de l'extraction des acides nucléiques.

### b. Préparation du contrôle CTL+

- Ajouter **200 µL** de « **NF-Water** » par tube.
- Homogénéiser le tube à l'aide d'un agitateur de type vortex > 20 secondes jusqu'à dissolution complète du culot bleu.
- Après reconstitution, aliquoter la solution et stocker la solution à une température inférieure à -15 °C jusqu'à la date de péremption du kit. Ne pas décongeler plus de 3 fois.
- Pour chaque analyse, utiliser **5 µL** du CTL+ dans un des puits dédiés (se reporter au § « Amplification », Etape 2).

## 3. Amplification

### Attention :

- Avant de commencer, décongeler les réactifs à température ambiante et à l'abri de la lumière.
- Homogénéiser tous les réactifs et échantillons avant utilisation.
- Replacer les réactifs à une température inférieure à -15 °C, après distribution.

**Étape 1 :** Répartir **10 µL** de réactif d'amplification A6 dans chaque puits PCR.

**Étape 2 :** Distribuer **5 µL** d'acides nucléiques extraits des échantillons et **5 µL** de contrôles dans chaque puits dédié.

Utiliser 5 µL de NF-Water pour le témoin réactif.

**Étape 3 :** Fermer les puits avec un film ou des barrettes adaptés.

**Étape 4 :** Démarrer l'analyse PCR.

Le programme suivant a été développé pour les appareils ABI Prism (type 7500, QuantStudio5, Step-one...) d'Applied Biosystems, pour les Mx3000 et Mx3005P, AriaMx d'Agilent, pour les LightCycler de Roche Diagnostics, pour le Rotor-Gene Q de Qiagen, pour le CFX96 et Chromo 4 de Biorad, pour le MIC de BioMolecular System.

Programme ADN/ARN	
10 min. 45 °C	
2 min. 95 °C	
5 sec. 95 °C	40 cycles
30 sec. 60 °C*	

\*Lecture et paramètres pour l'acquisition de la fluorescence :

Fluorochrome	Absorbance (nm)	Emission (nm)
FAM	494	520
HEX ou équivalent	538	554
Cy5	646	662
ROX	575	602

**Note :** Le Quencher est non fluorescent. Le mélange contient une référence passive lue dans le spectre du ROX pour les appareils ABI Prism.

Contactez votre représentant commercial ou le service client pour tout autre modèle de thermocycleur.

## H. Interprétation des résultats

Afficher l'ensemble des courbes et positionner la ligne de seuil pour chaque fluorochrome.

### 1. Validation de l'essai

L'amplification est valide si les résultats suivants sont obtenus.

Les valeurs indicatives de Ct (Threshold Cycle) attendues pour le CTL+ sont indiquées sur le certificat d'analyse du kit.

Contrôles	Amplification			Validation de
	FAM (ASFV)	Cy5 (EPC-Ext)	HEX (Endogène)	
Témoin réactif (NTC)	Non	Non	Non	Absence de contamination pour l'amplification
ASFV CTL+	Oui	Non	Oui	Amplification de la cible
Témoin négatif d'extraction	Non	Oui	Non	Absence de contamination pour l'extraction
Témoin positif d'extraction	Oui	Oui	Oui/Non	Étapes d'extraction et d'amplification

### 2. Interprétation des résultats

L'extraction des acides nucléiques et l'amplification sont **valides** pour chacun des échantillons si au moins une courbe d'amplification caractéristique est observée en FAM, Cy5 et/ou HEX ou équivalent.

Amplification			Interprétation
FAM (ASFV)	Cy5 (EPC-Ext)	HEX (Endogène)	ASFV
Oui	Oui	Oui	DéTECTÉ
Oui	Non	Oui	DéTECTÉ
Oui	Oui	Non	DéTECTÉ
Oui	Non	Non	DéTECTÉ
Non	Oui	Oui	Non détecté
Non	Non	Oui	Ininterprétable <sup>1</sup>
Non	Oui	Non	Non détecté si matrice acellulaire
			Ininterprétable <sup>2</sup>
Non	Non	Non	Ininterprétable <sup>3</sup>

« **Ininterprétable** » : absence de courbe d'amplification caractéristique de contrôles critiques.

**Causes possibles :**

<sup>1</sup> Problème d'extraction et/ou inhibition de la PCR.

<sup>2</sup> Échantillon dégradé ou oublié lors de l'extraction.

<sup>3</sup> Potentielle erreur/inhibition de la PCR ou erreur lors de l'extraction.

**Actions conseillées :**

Refaire la PCR avec l'extrait des acides nucléiques pur et dilué au 1/10<sup>ème</sup> en eau Nucléase-free ou refaire l'extraction des acides nucléiques.

Si le test n'est toujours pas valide, redemander un autre prélèvement.

## Table des symboles

Symbole	Signification
	Référence du catalogue
	Fabricant
	Limite supérieure de température
	Utiliser jusqu'à
	Code du lot
	Consulter les instructions d'utilisation
	Contenu suffisant pour "n" tests
	Pour usage vétérinaire <i>in vitro</i> uniquement – Pour usage animal uniquement
	Conserver à l'abri de la lumière
	Conserver au sec

1 | Extraire les acides nucléiques avec

**Adia<sup>X</sup>  
Mag**



Scan me to discover Adiamag™


2 | Ajouter **1000 µL** de Rehydration buffer au réactif d'amplification **A6**





3 | Répartir **10 µL** de réactif d'amplification **A6**

4 | Distribuer **5 µL** d'acides nucléiques, **CTL+** et **NF-Water**

5 | Sceller les puits

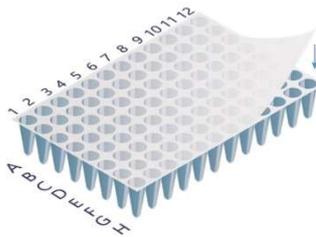

6 | Démarrer l'analyse PCR

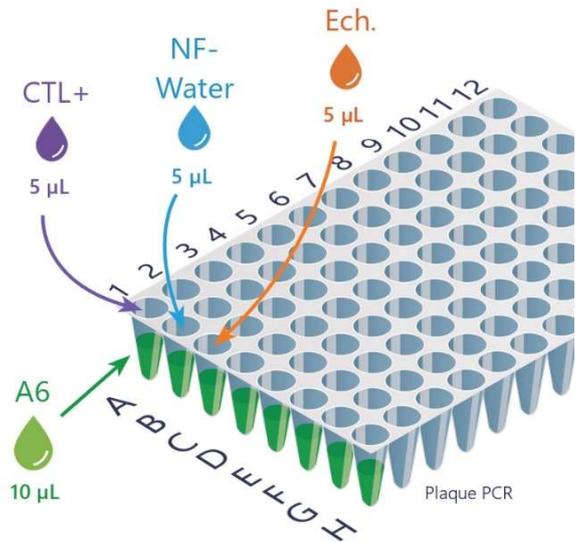

\* Les notes ne se substituent pas au mode d'emploi dont elles sont une synthèse.